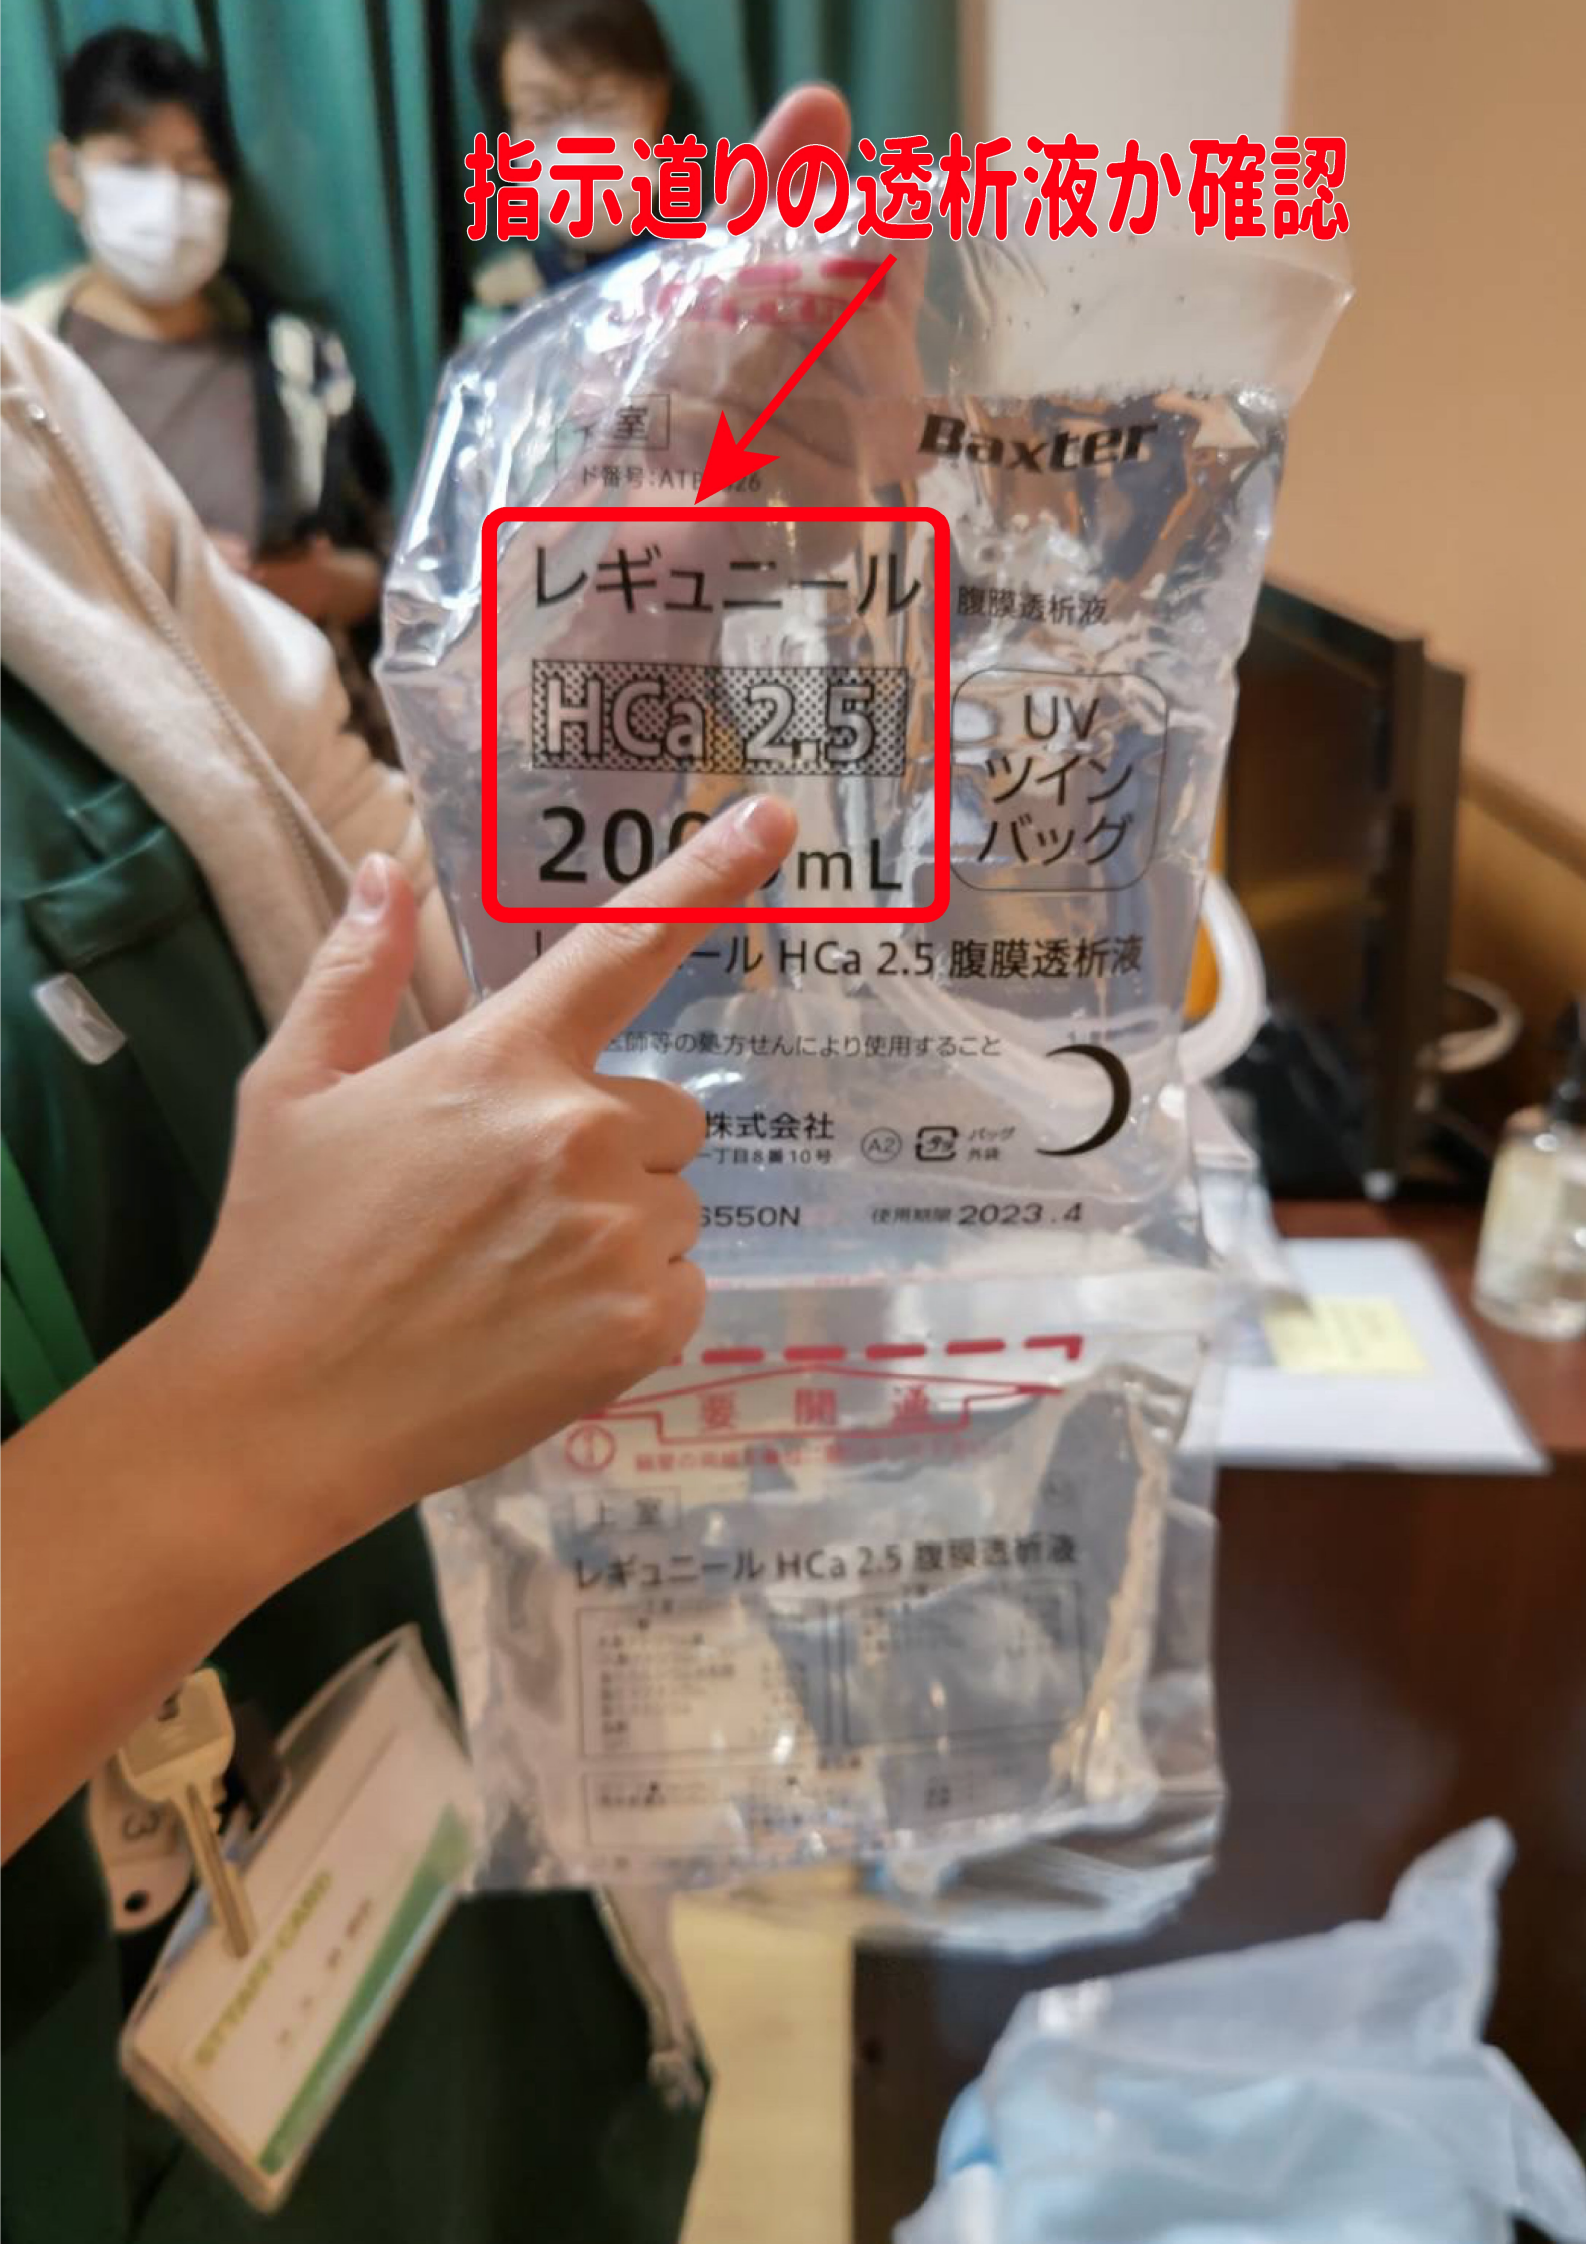
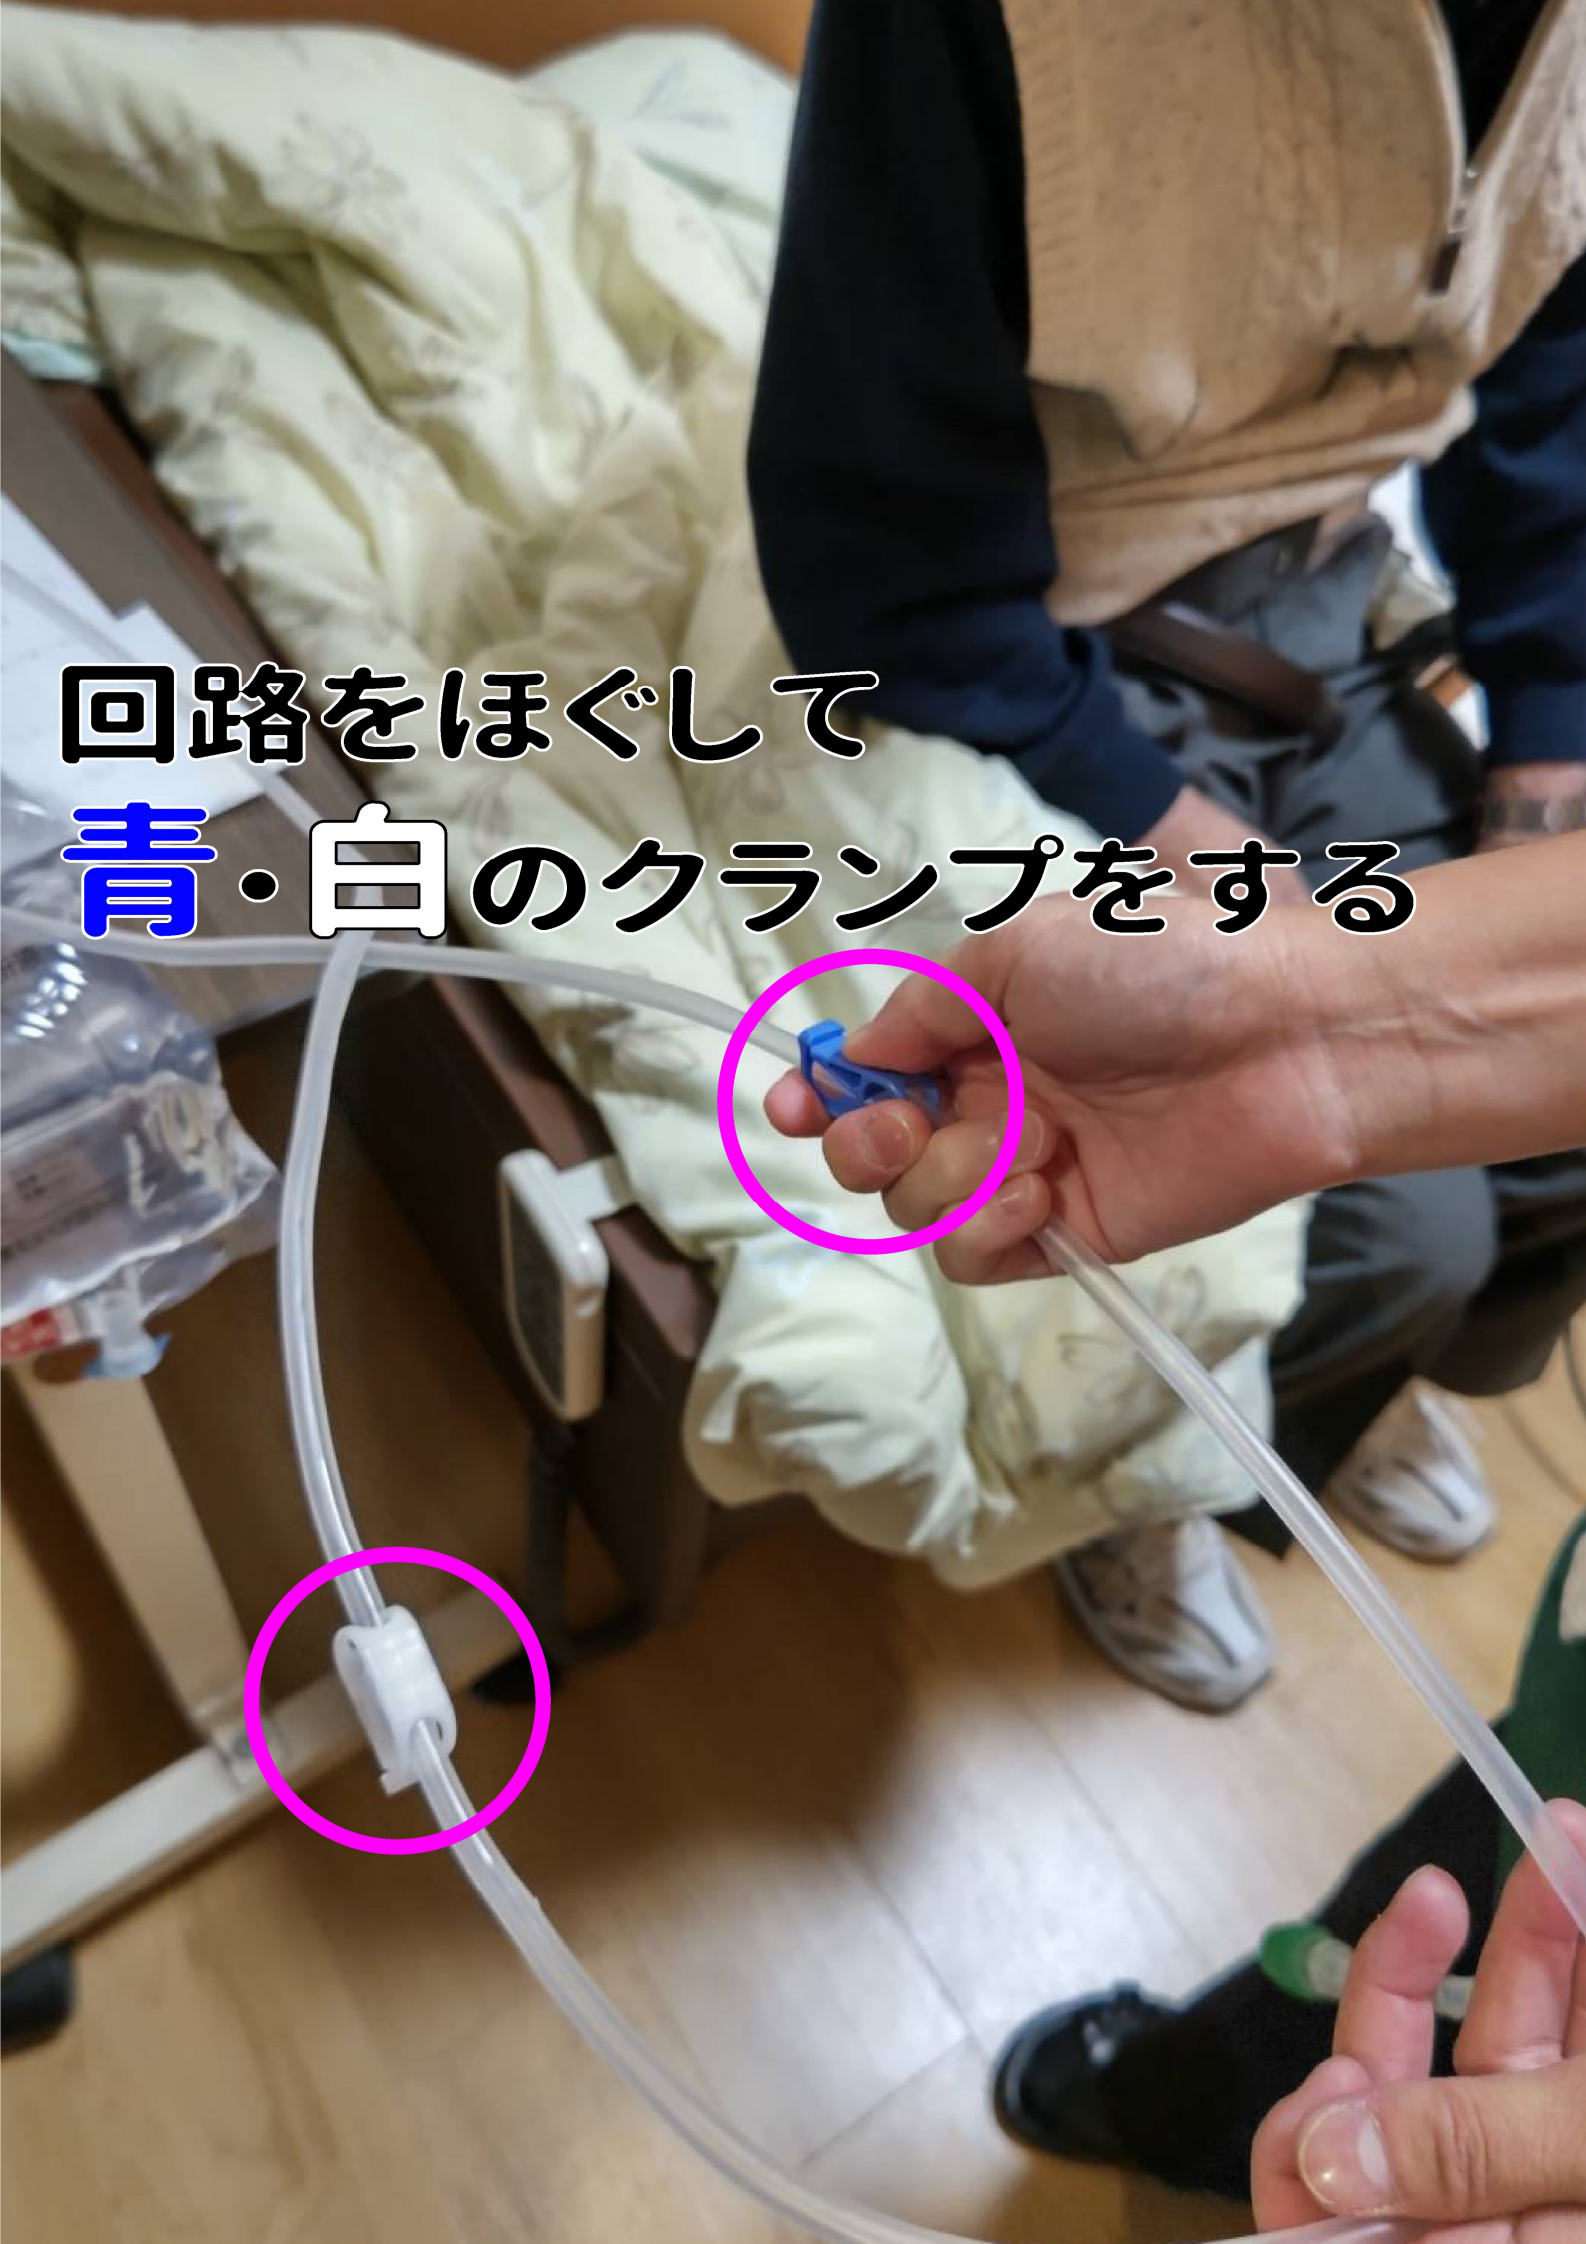
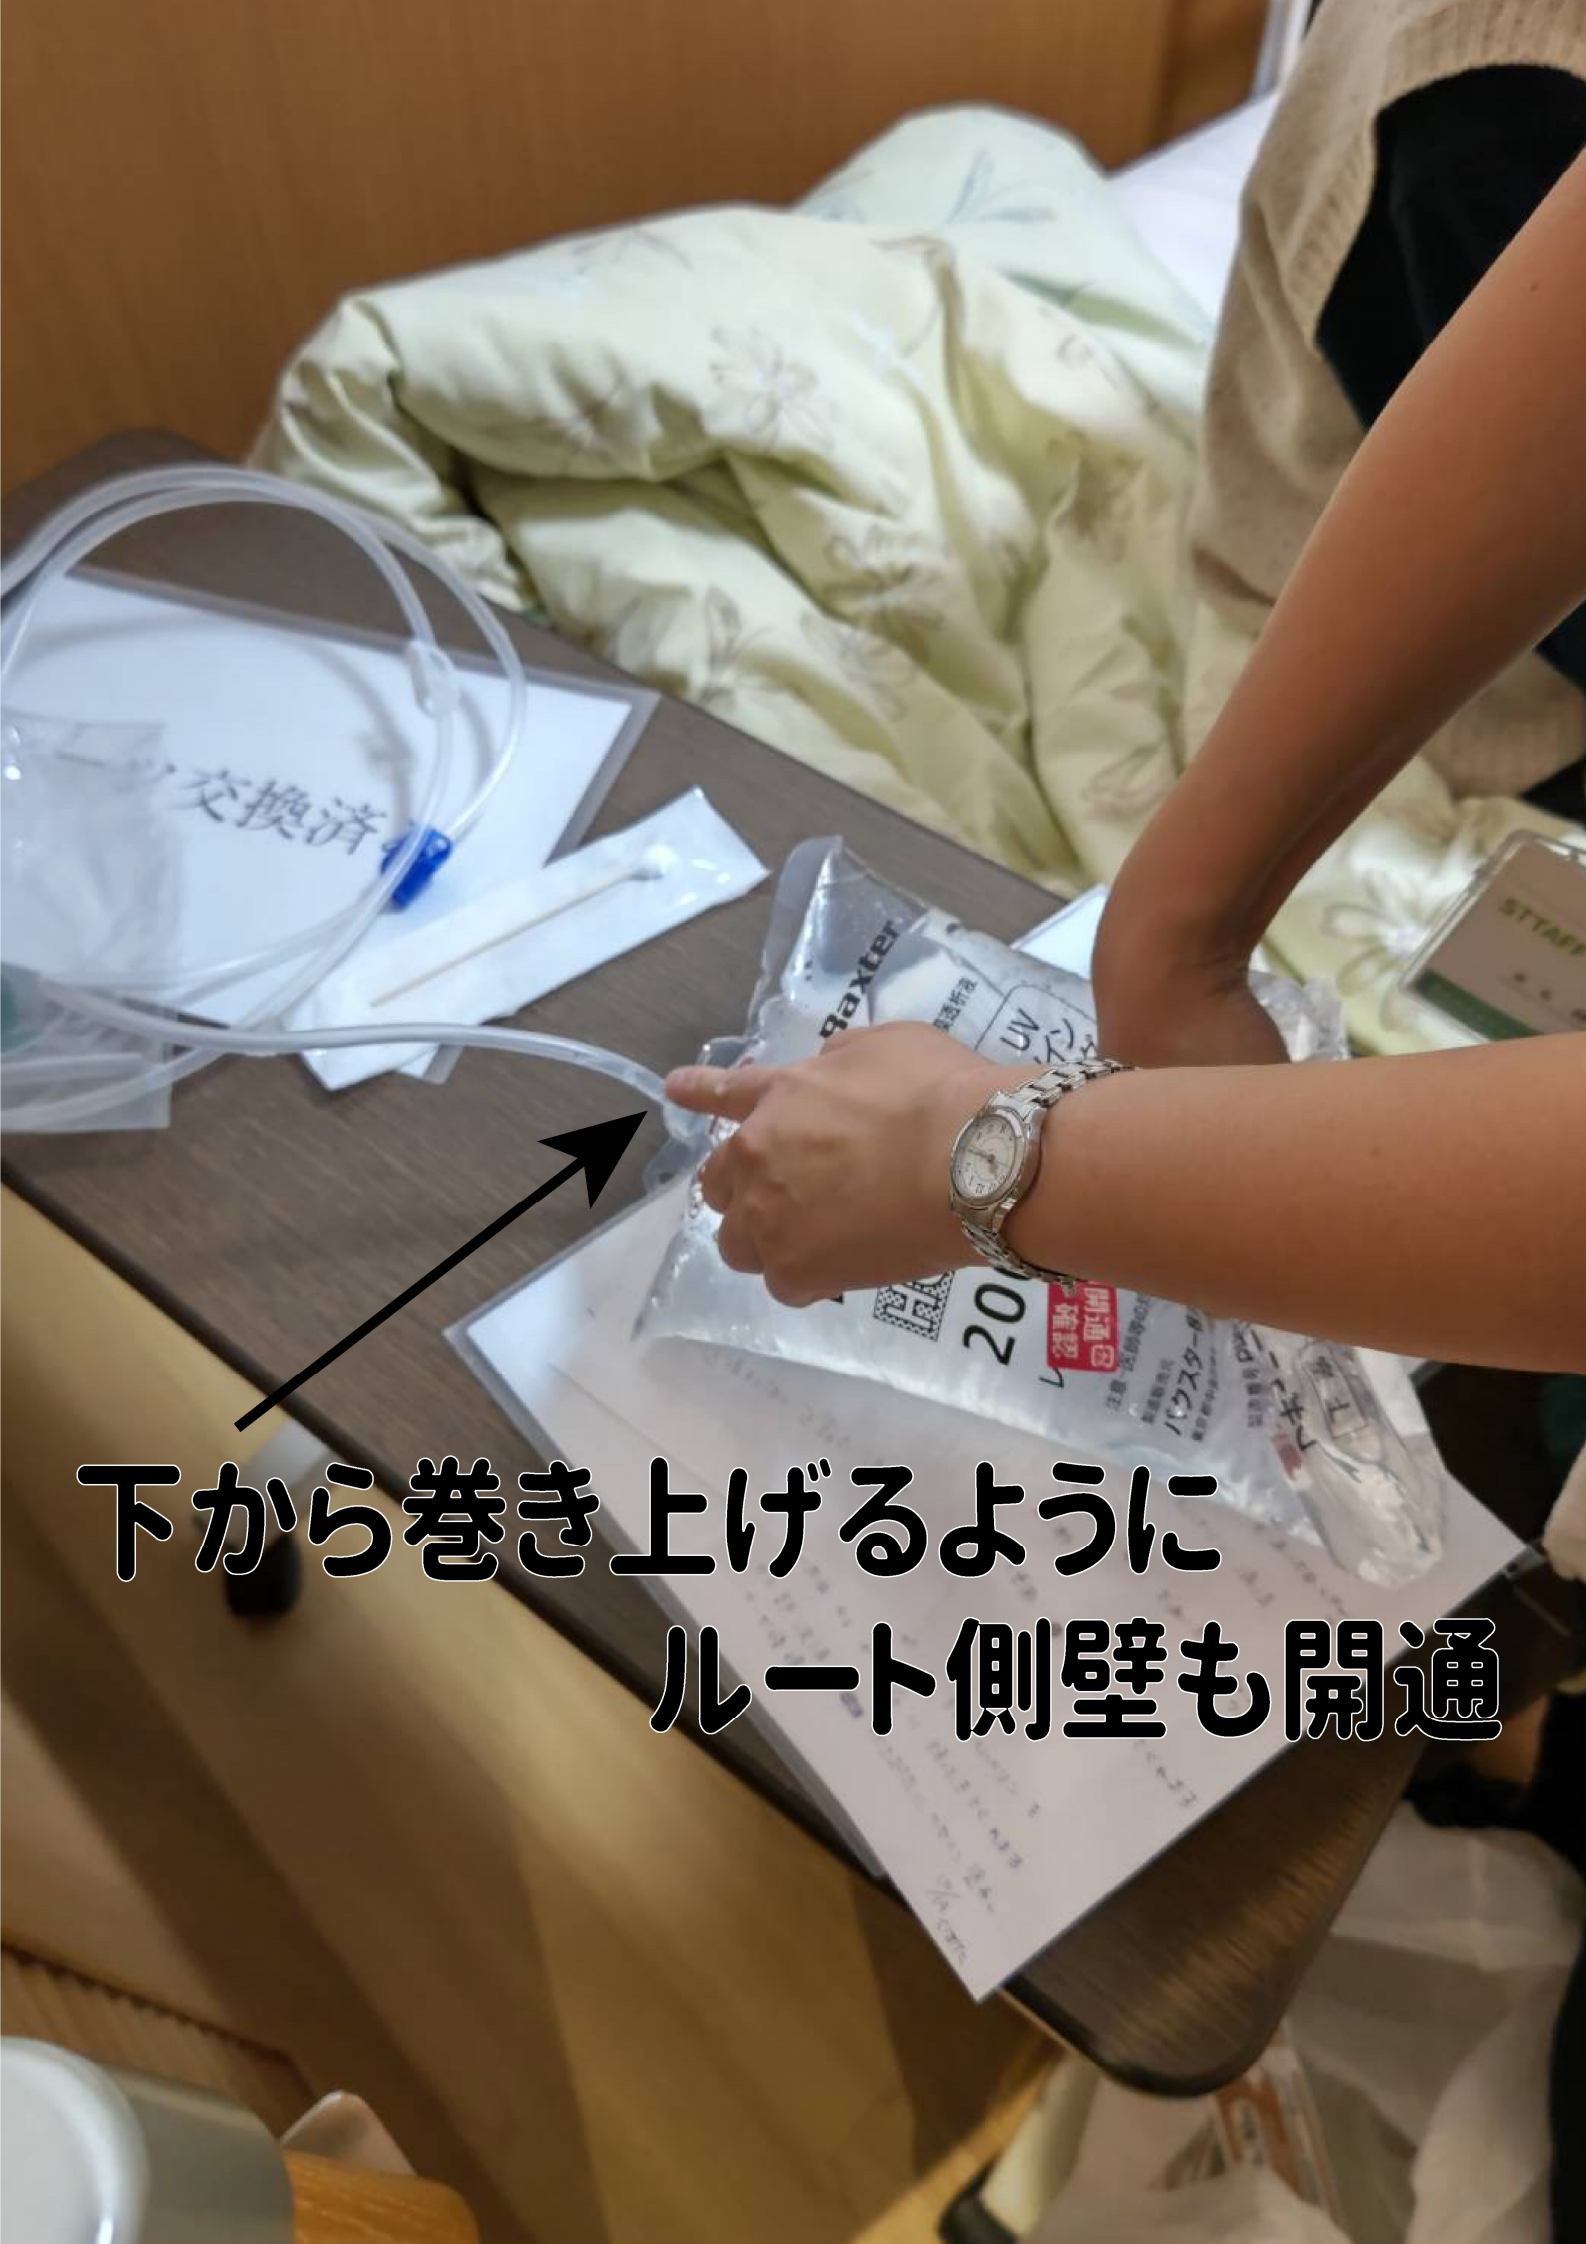

トイレ確認
マスク装着
手洗い（アルコール消毒）
加温器内の1番下の物から使用


指示道りの透析液か確認
Baxter
レギュニール
腹膜透析液
HCa 2.5
UV
ツイン
バッグ
mL
ール HCa 2.5 腹膜透析液
師等の処方せんにより使用すること
株式会社
6550N
使用期限 2023.4
要開通
レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液


回路をほぐして
青・白のクランプをする


隔壁開通をして混合させる
※隔壁開通方法はDVDを確認
レギュニール
HCa 2.5
2000mL
UV
ツイン
バッグ
PH6523N
2023.3
①→②の順で開通させて下さい


下から巻き上げるように
ルート側壁も開通


緑の先端を
「つなぐ」にセット



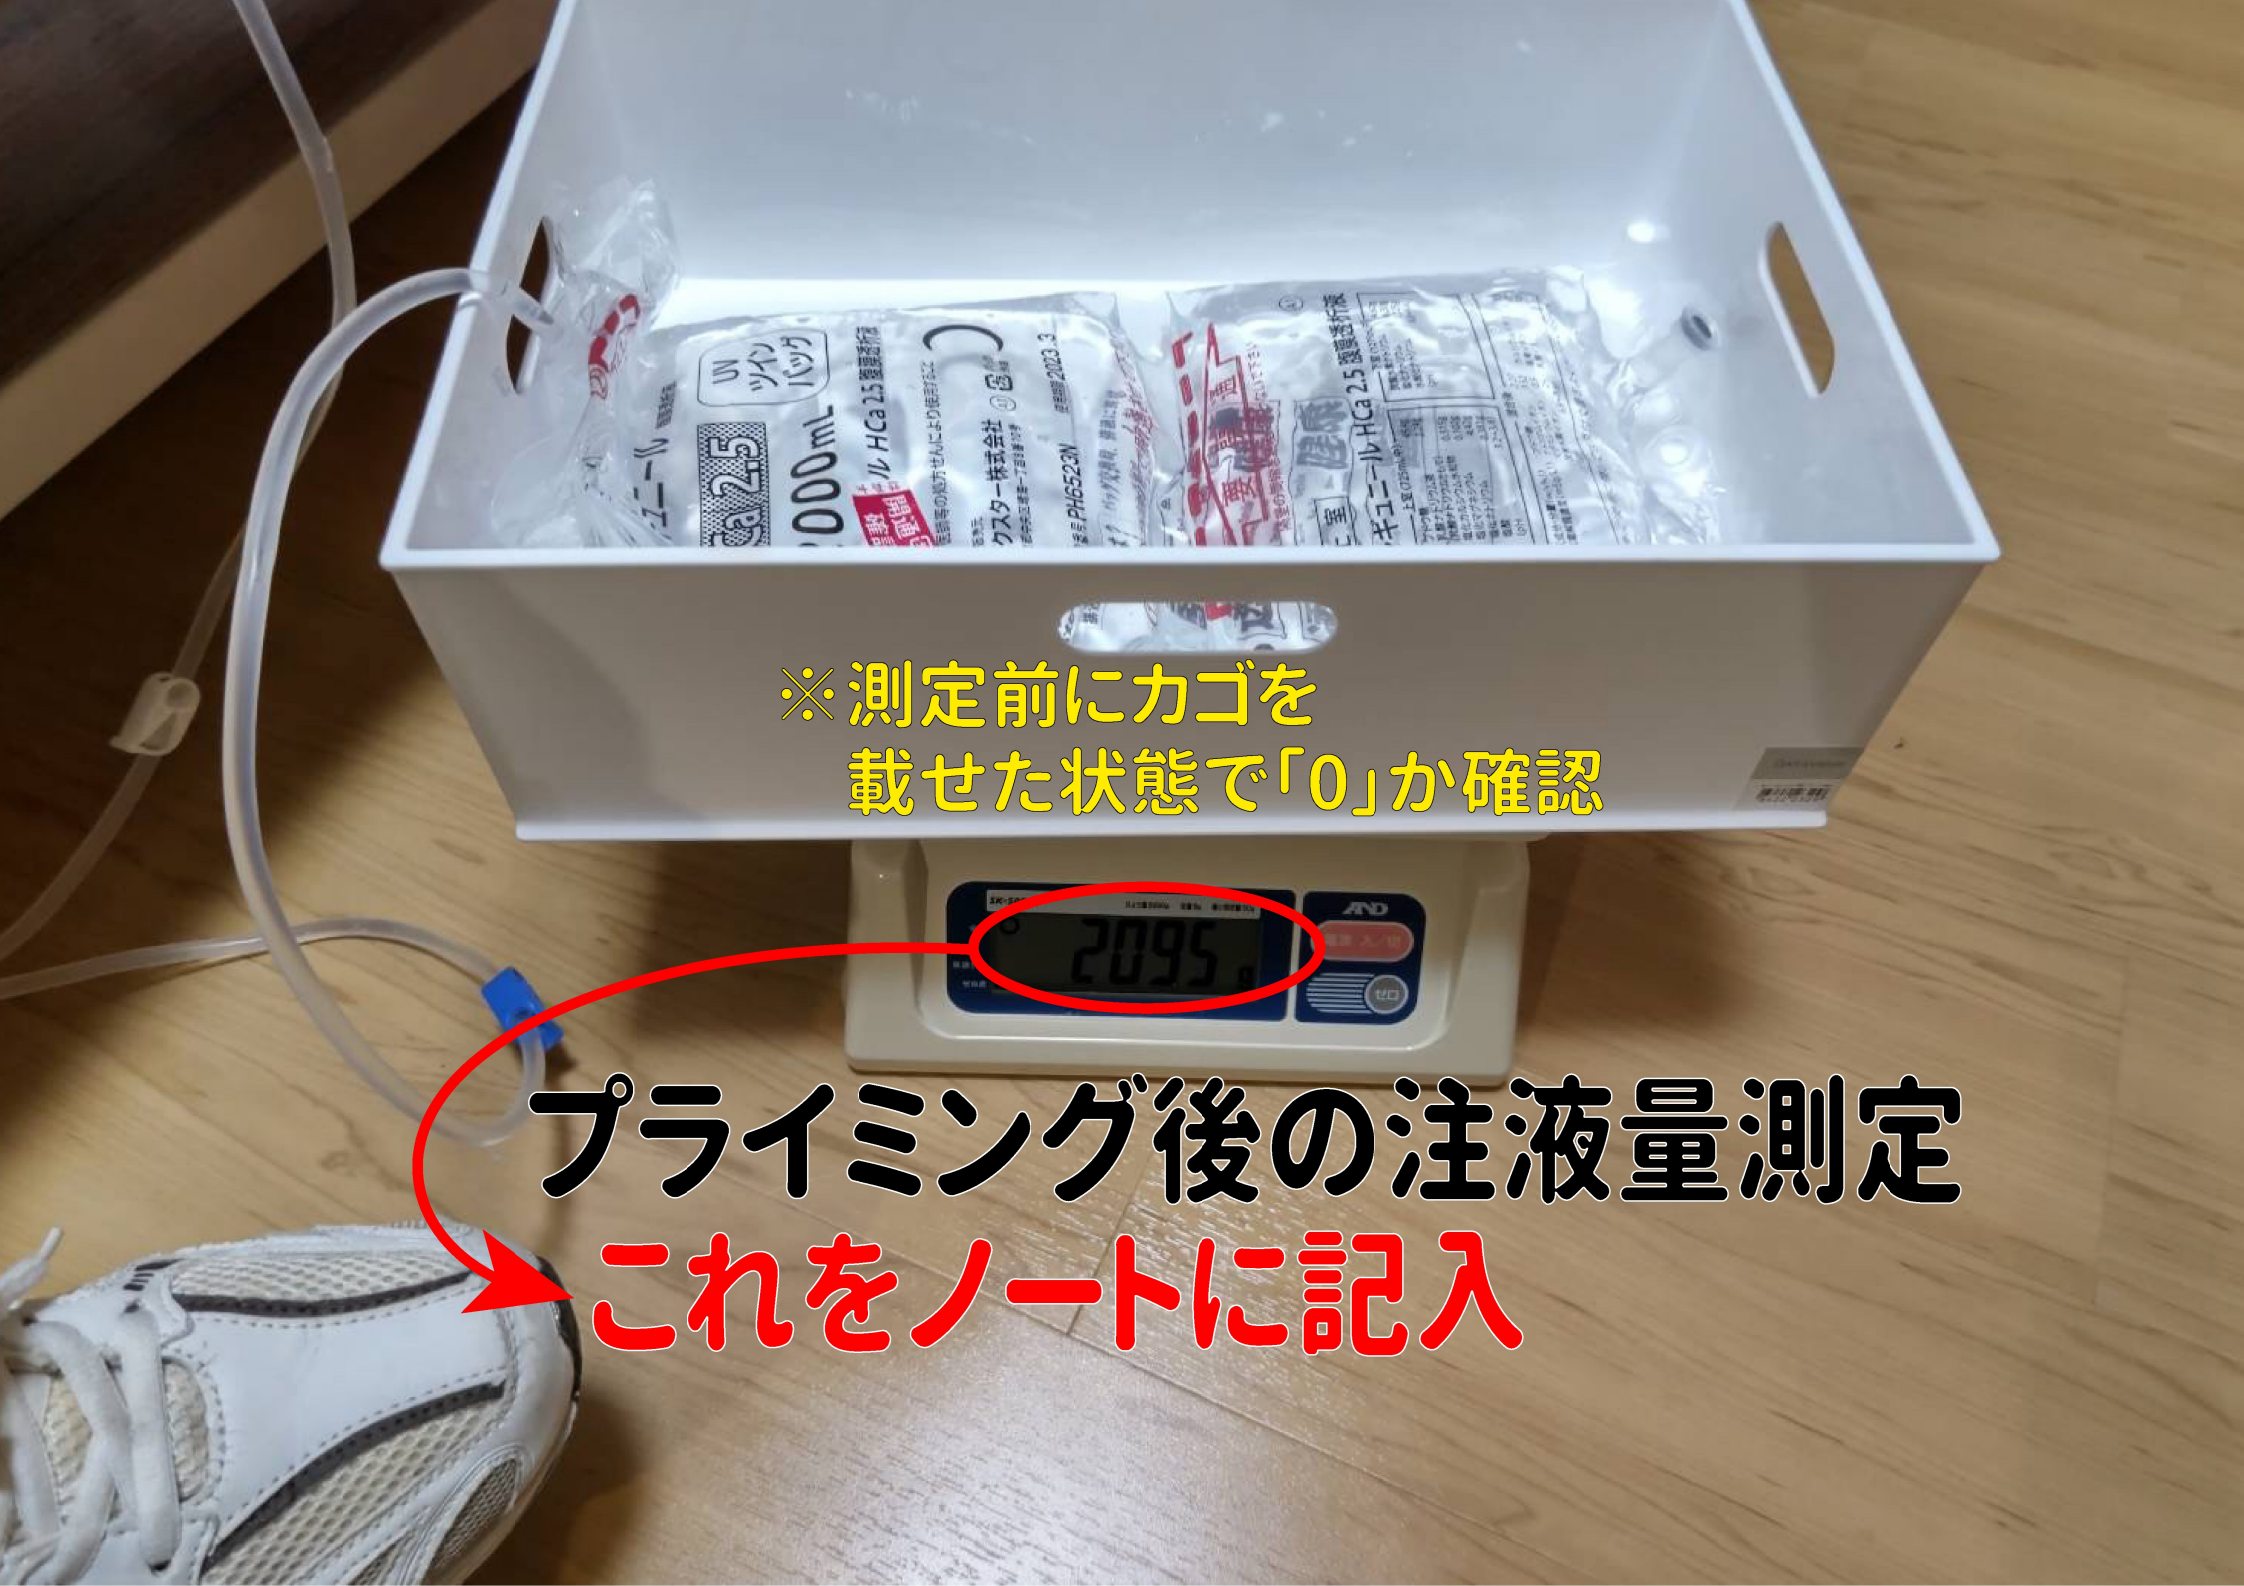
自身のカテーテル先端を
「つなぐ」にセット


開閉ねじ
ここが
閉まっているか
確認
「つなぐ」
接続後の
状態です


青クランプ開放


白クランプを開放して
5秒程透析液を流して
プライミングをする


尿量
Campus
KOKUYO
5秒流したら
青・白クランプを閉じる


※測定前にカゴを
載せた状態で「0」か確認
2095
プライミング後の注液量測定
これをノートに記入

排液時間		20分	25分	分
排液の確認		正常 フィブリン 混濁 他( )	正常 フィブリン 混濁 他( )	正常 フィブリン 混濁 他( )

一日の総除水量	425 g	体重	51.5 kg	備考
尿量	ml	排便	回	
飲水量	ml	血圧	104/58 mmHg	
出口部の状態	正常・赤み・痛み・はれ・かさぶた・じゅくじゅく 出血・膿（色 ）その他			

3 年 10 月 21 日 木 曜日

貯留時間	10:00～ :	: ～ :	: ～ :
透析液濃度	レタ 1.5・2.5・4.25・エ	1.5・2.5・4.25・エ	レタ 1.5・2.5・4.25・エ
排液量	g	g	g
注液量	2095 g	g	g
除水量	g	g	g
排液時間	分	分	分
排液の確認	正常 フィブリン 混濁 他( )	正常 フィブリン 混濁 他( )	正常 フィブリン 混濁 他( )

ここに記入

一日の総除水量		体重	50.8 kg	備考
尿量	ml	排便	回	
飲水量	990 ml	血圧	96/51 mmHg	
出口部の状態	正常・赤み・痛み・はれ・かさぶた・じゅくじゅく 出血・膿（色 ）その他			


青クランプを開けます


まわして開けます
そうすると注液開始です
※注液に10分以上かかるのでその間にバイタル等を


注液後まわして閉める


尿量
青クランプを閉じる


緑のキャップ（新しいもの）
を本人がセット



「つなぐ」で回路を切り離します



切り離されたカテーテルを
本人がコンパクトにまとめます

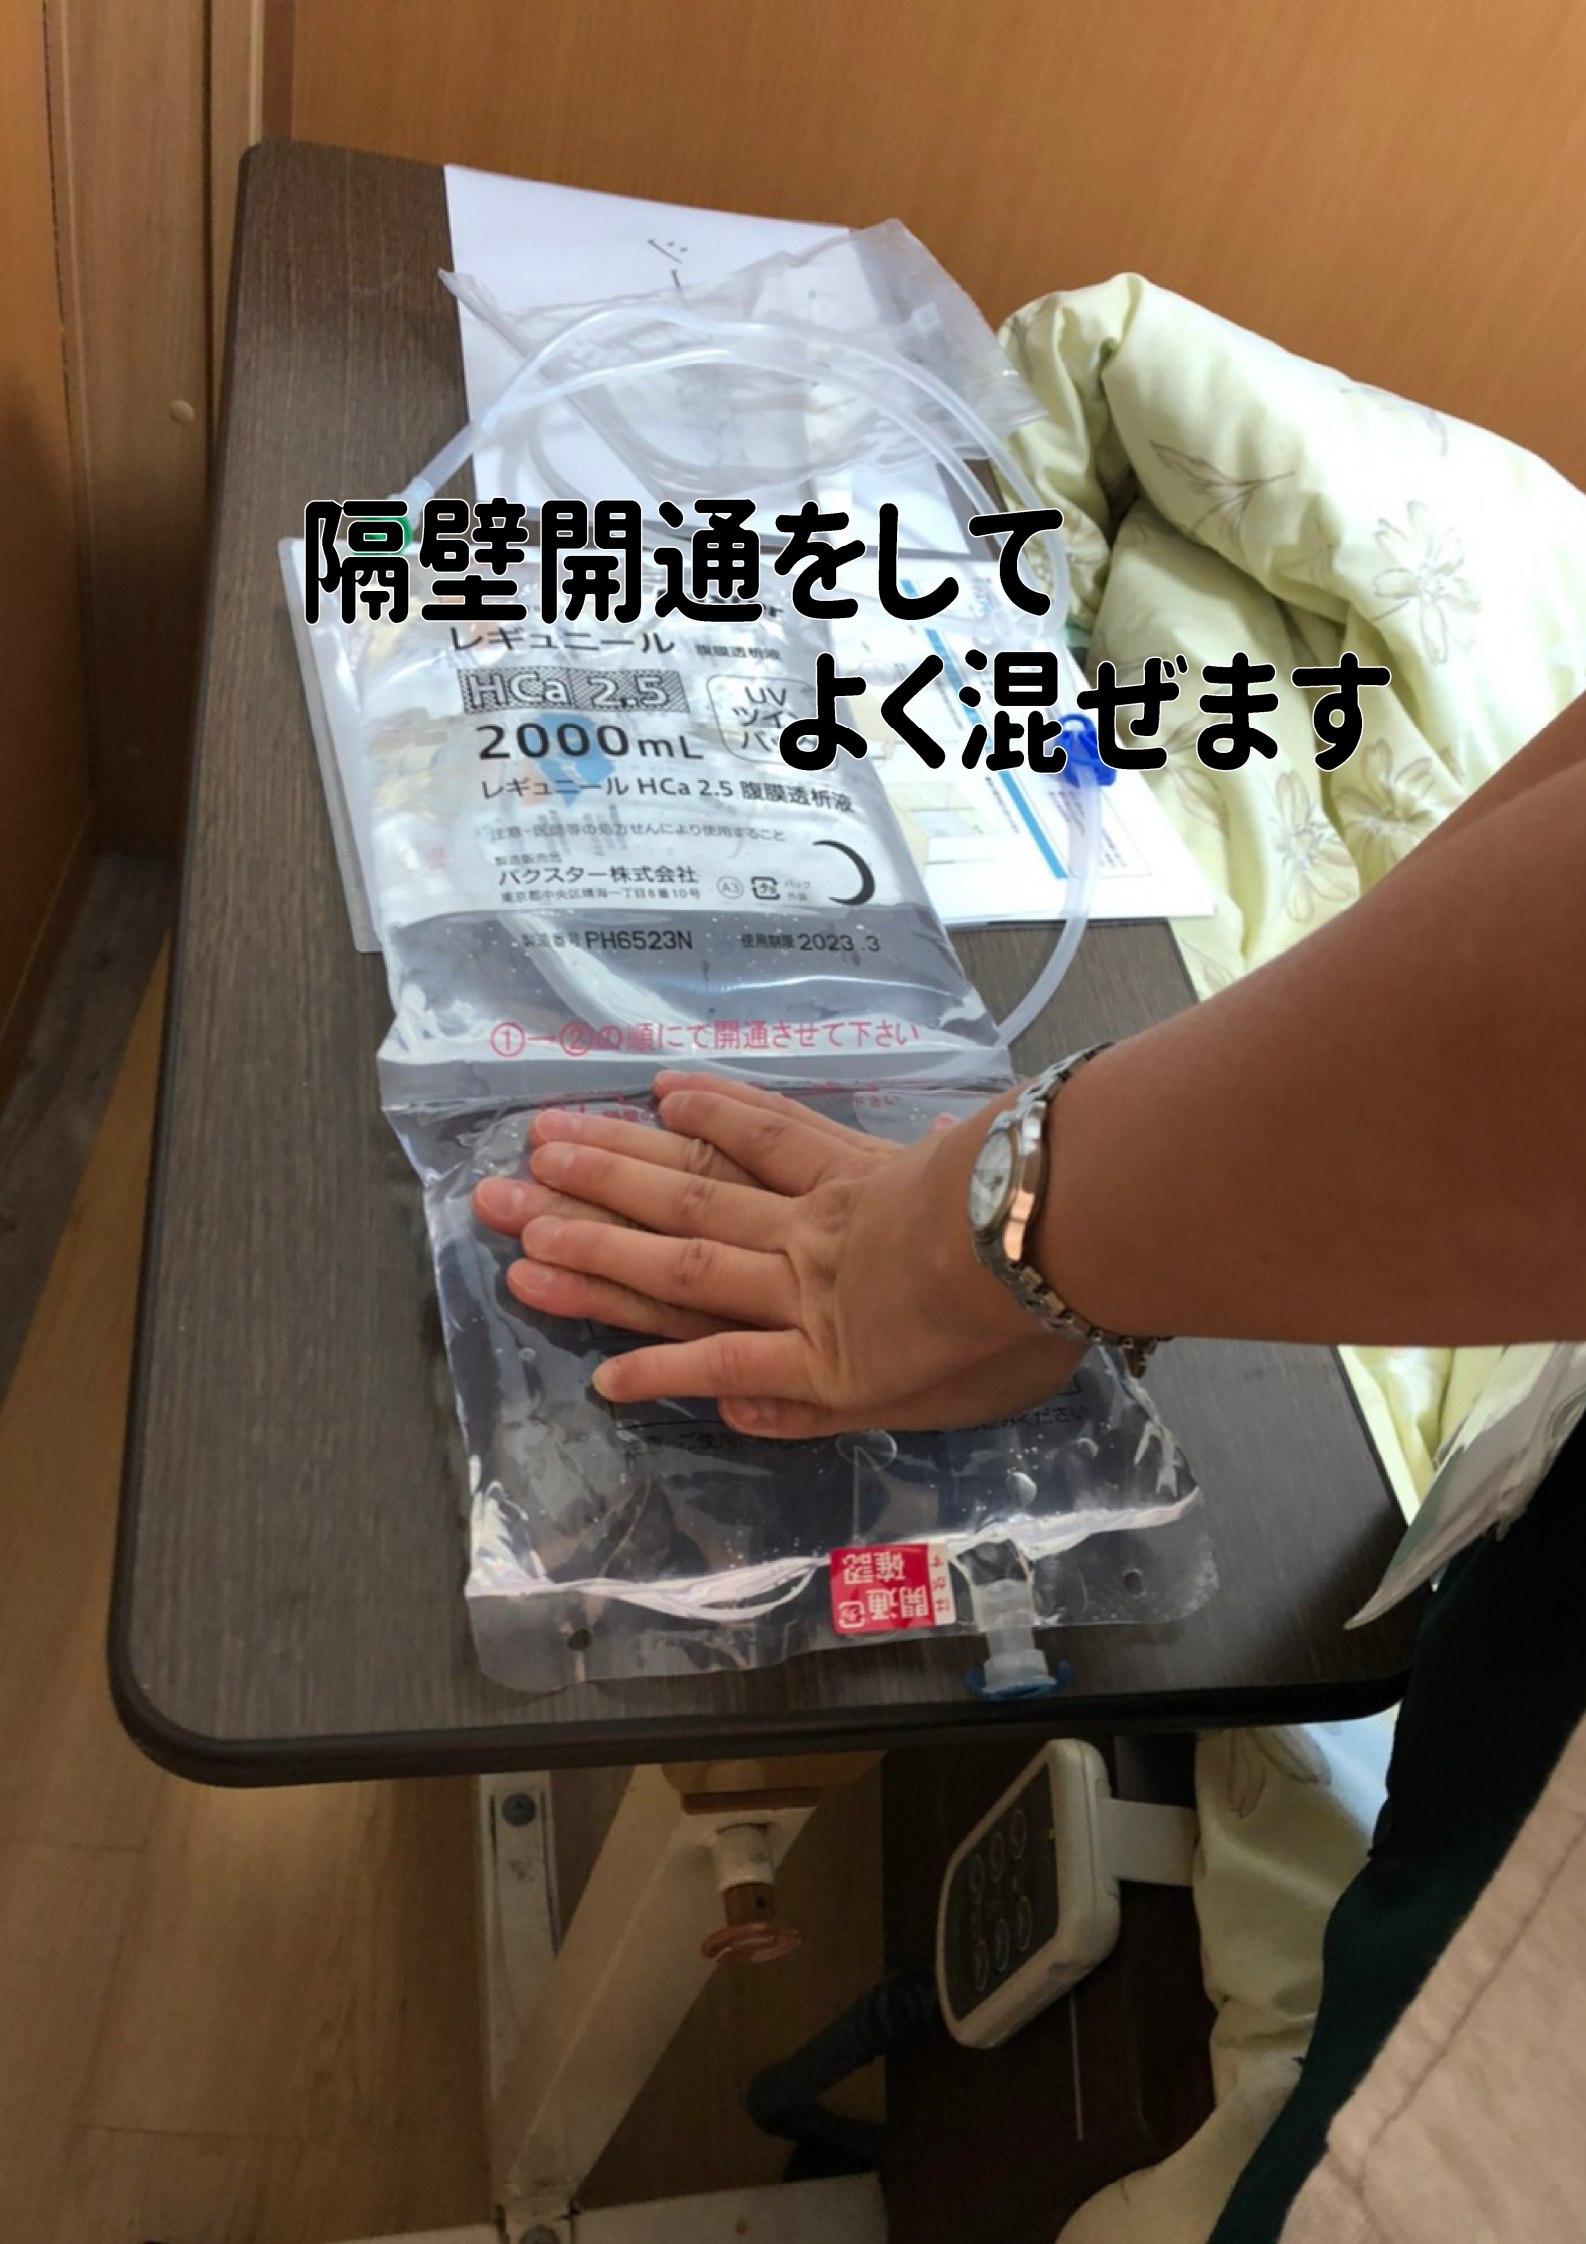

腹まきの内に収納
（腹まきと腹まきの間に入れこむ形で）


透析液を取り出します
マスク装着
手洗い(アルコール消毒)


透析液開封し
回路をばらします
青・白クランプを閉めます

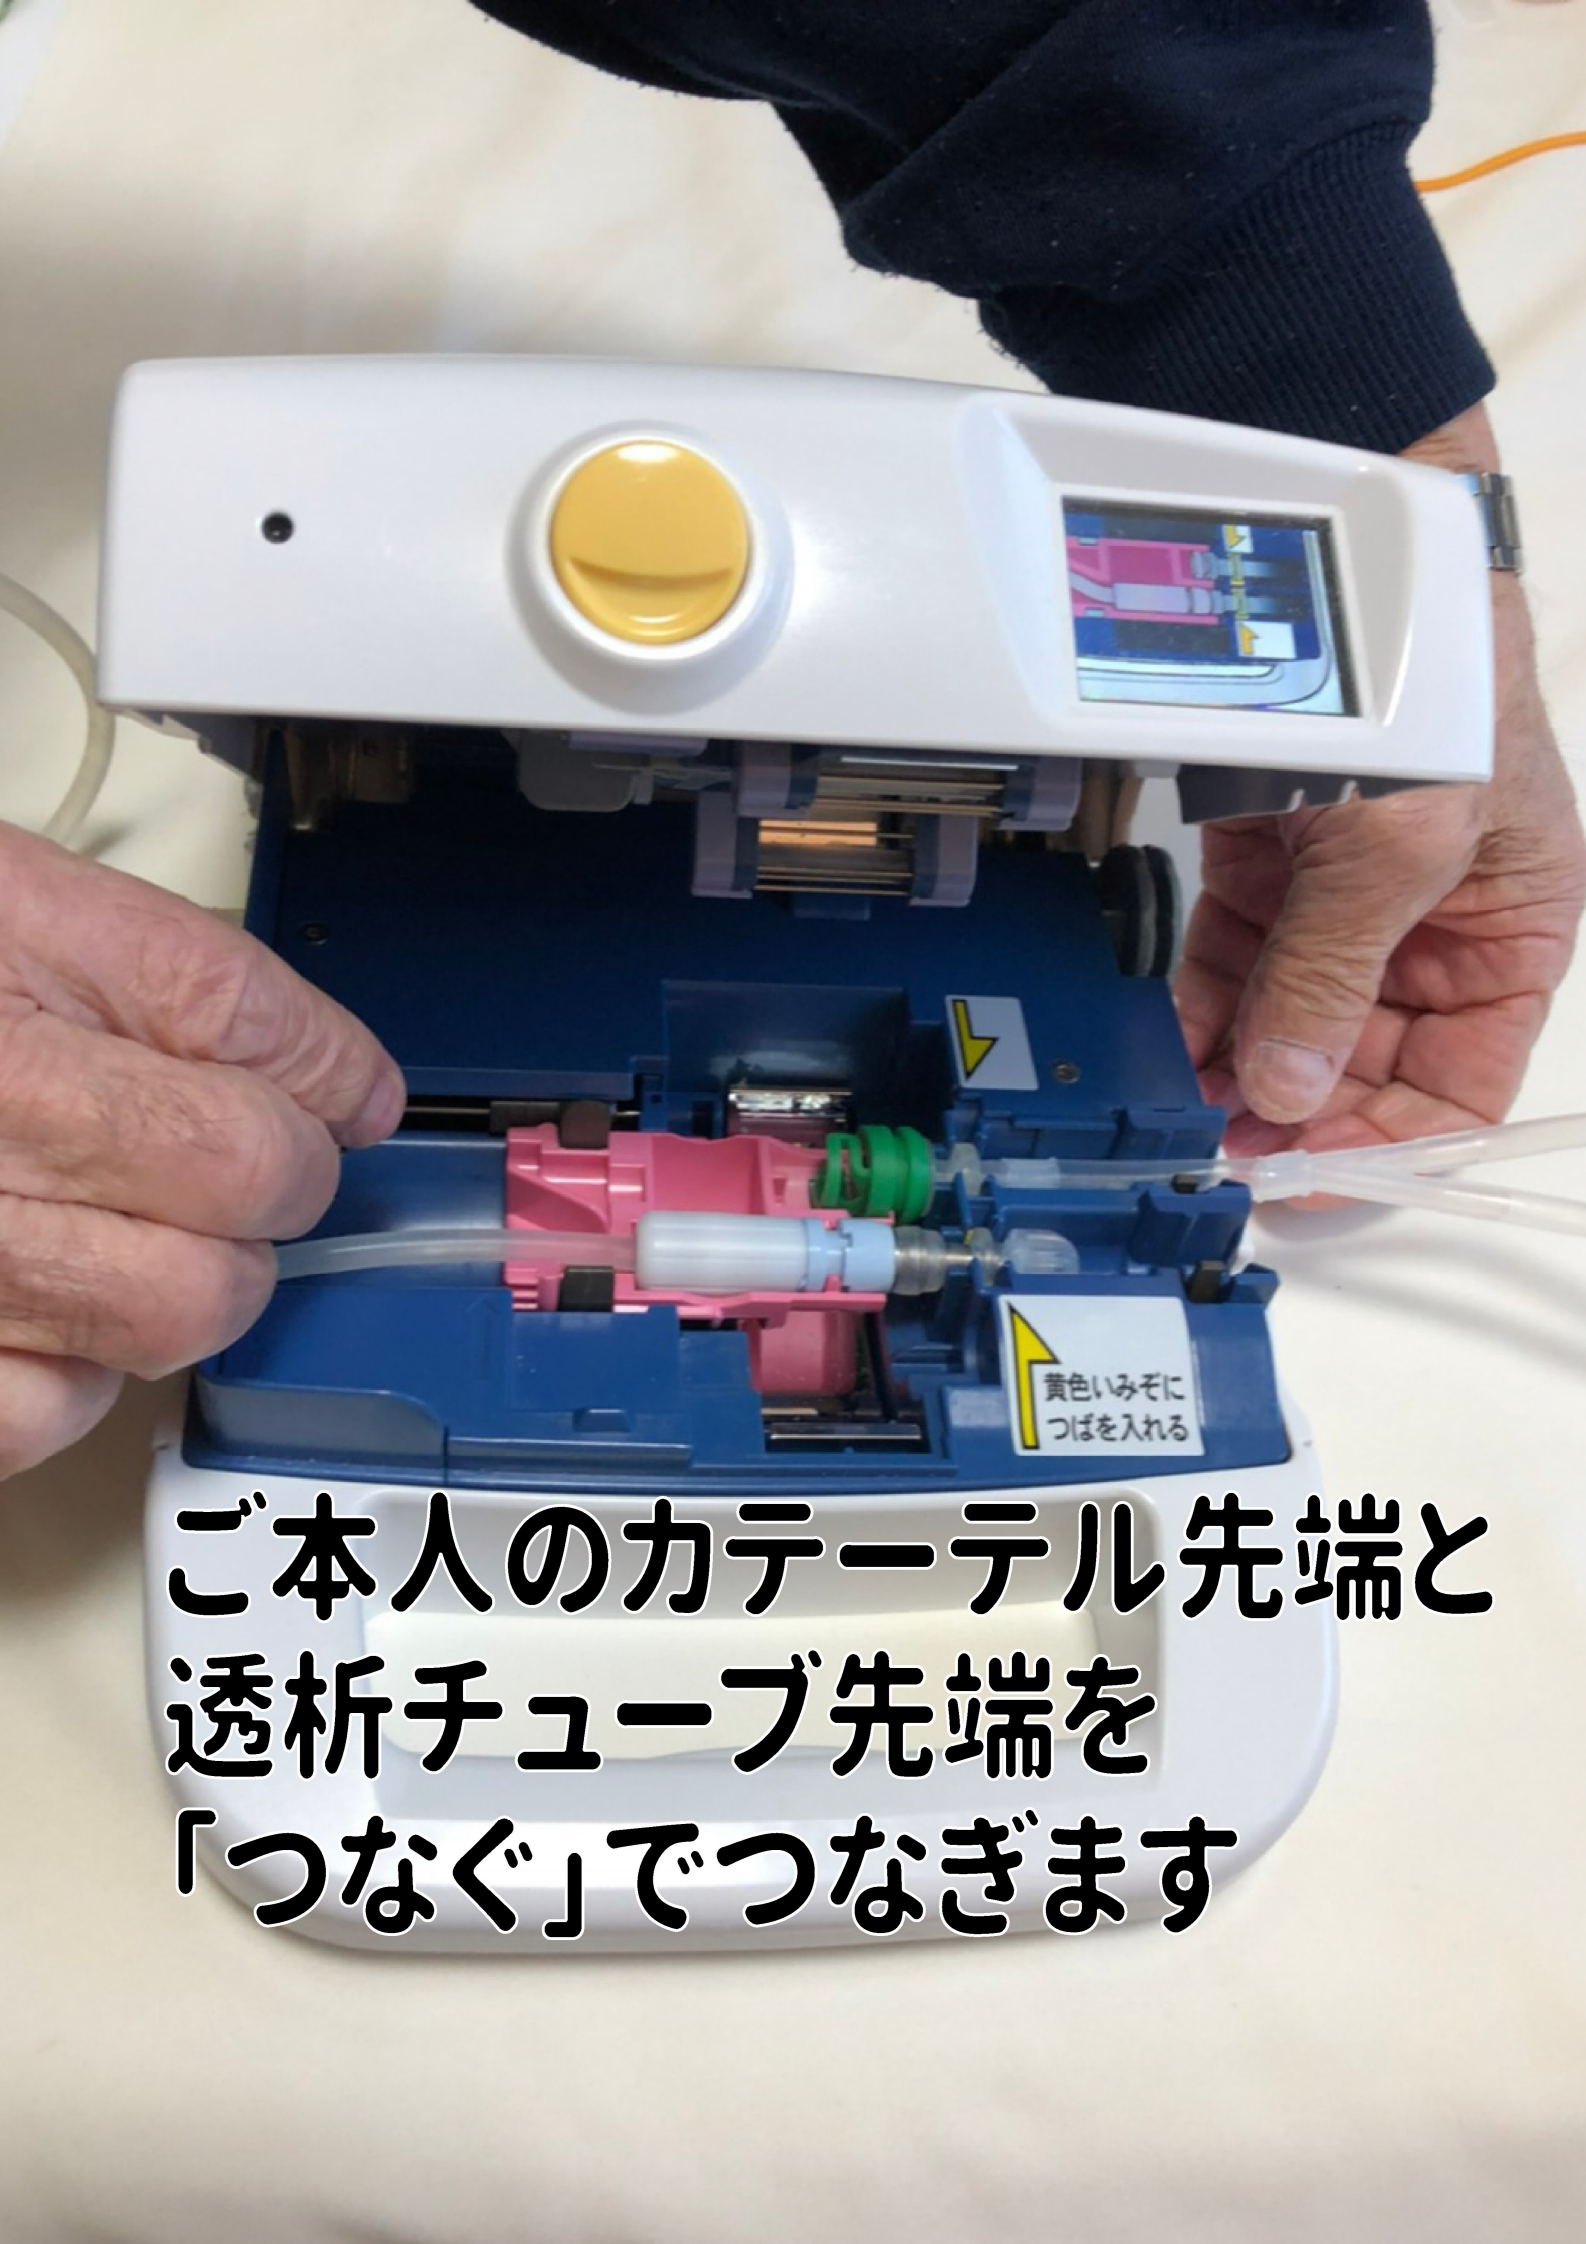

青クランプ


白クランプ

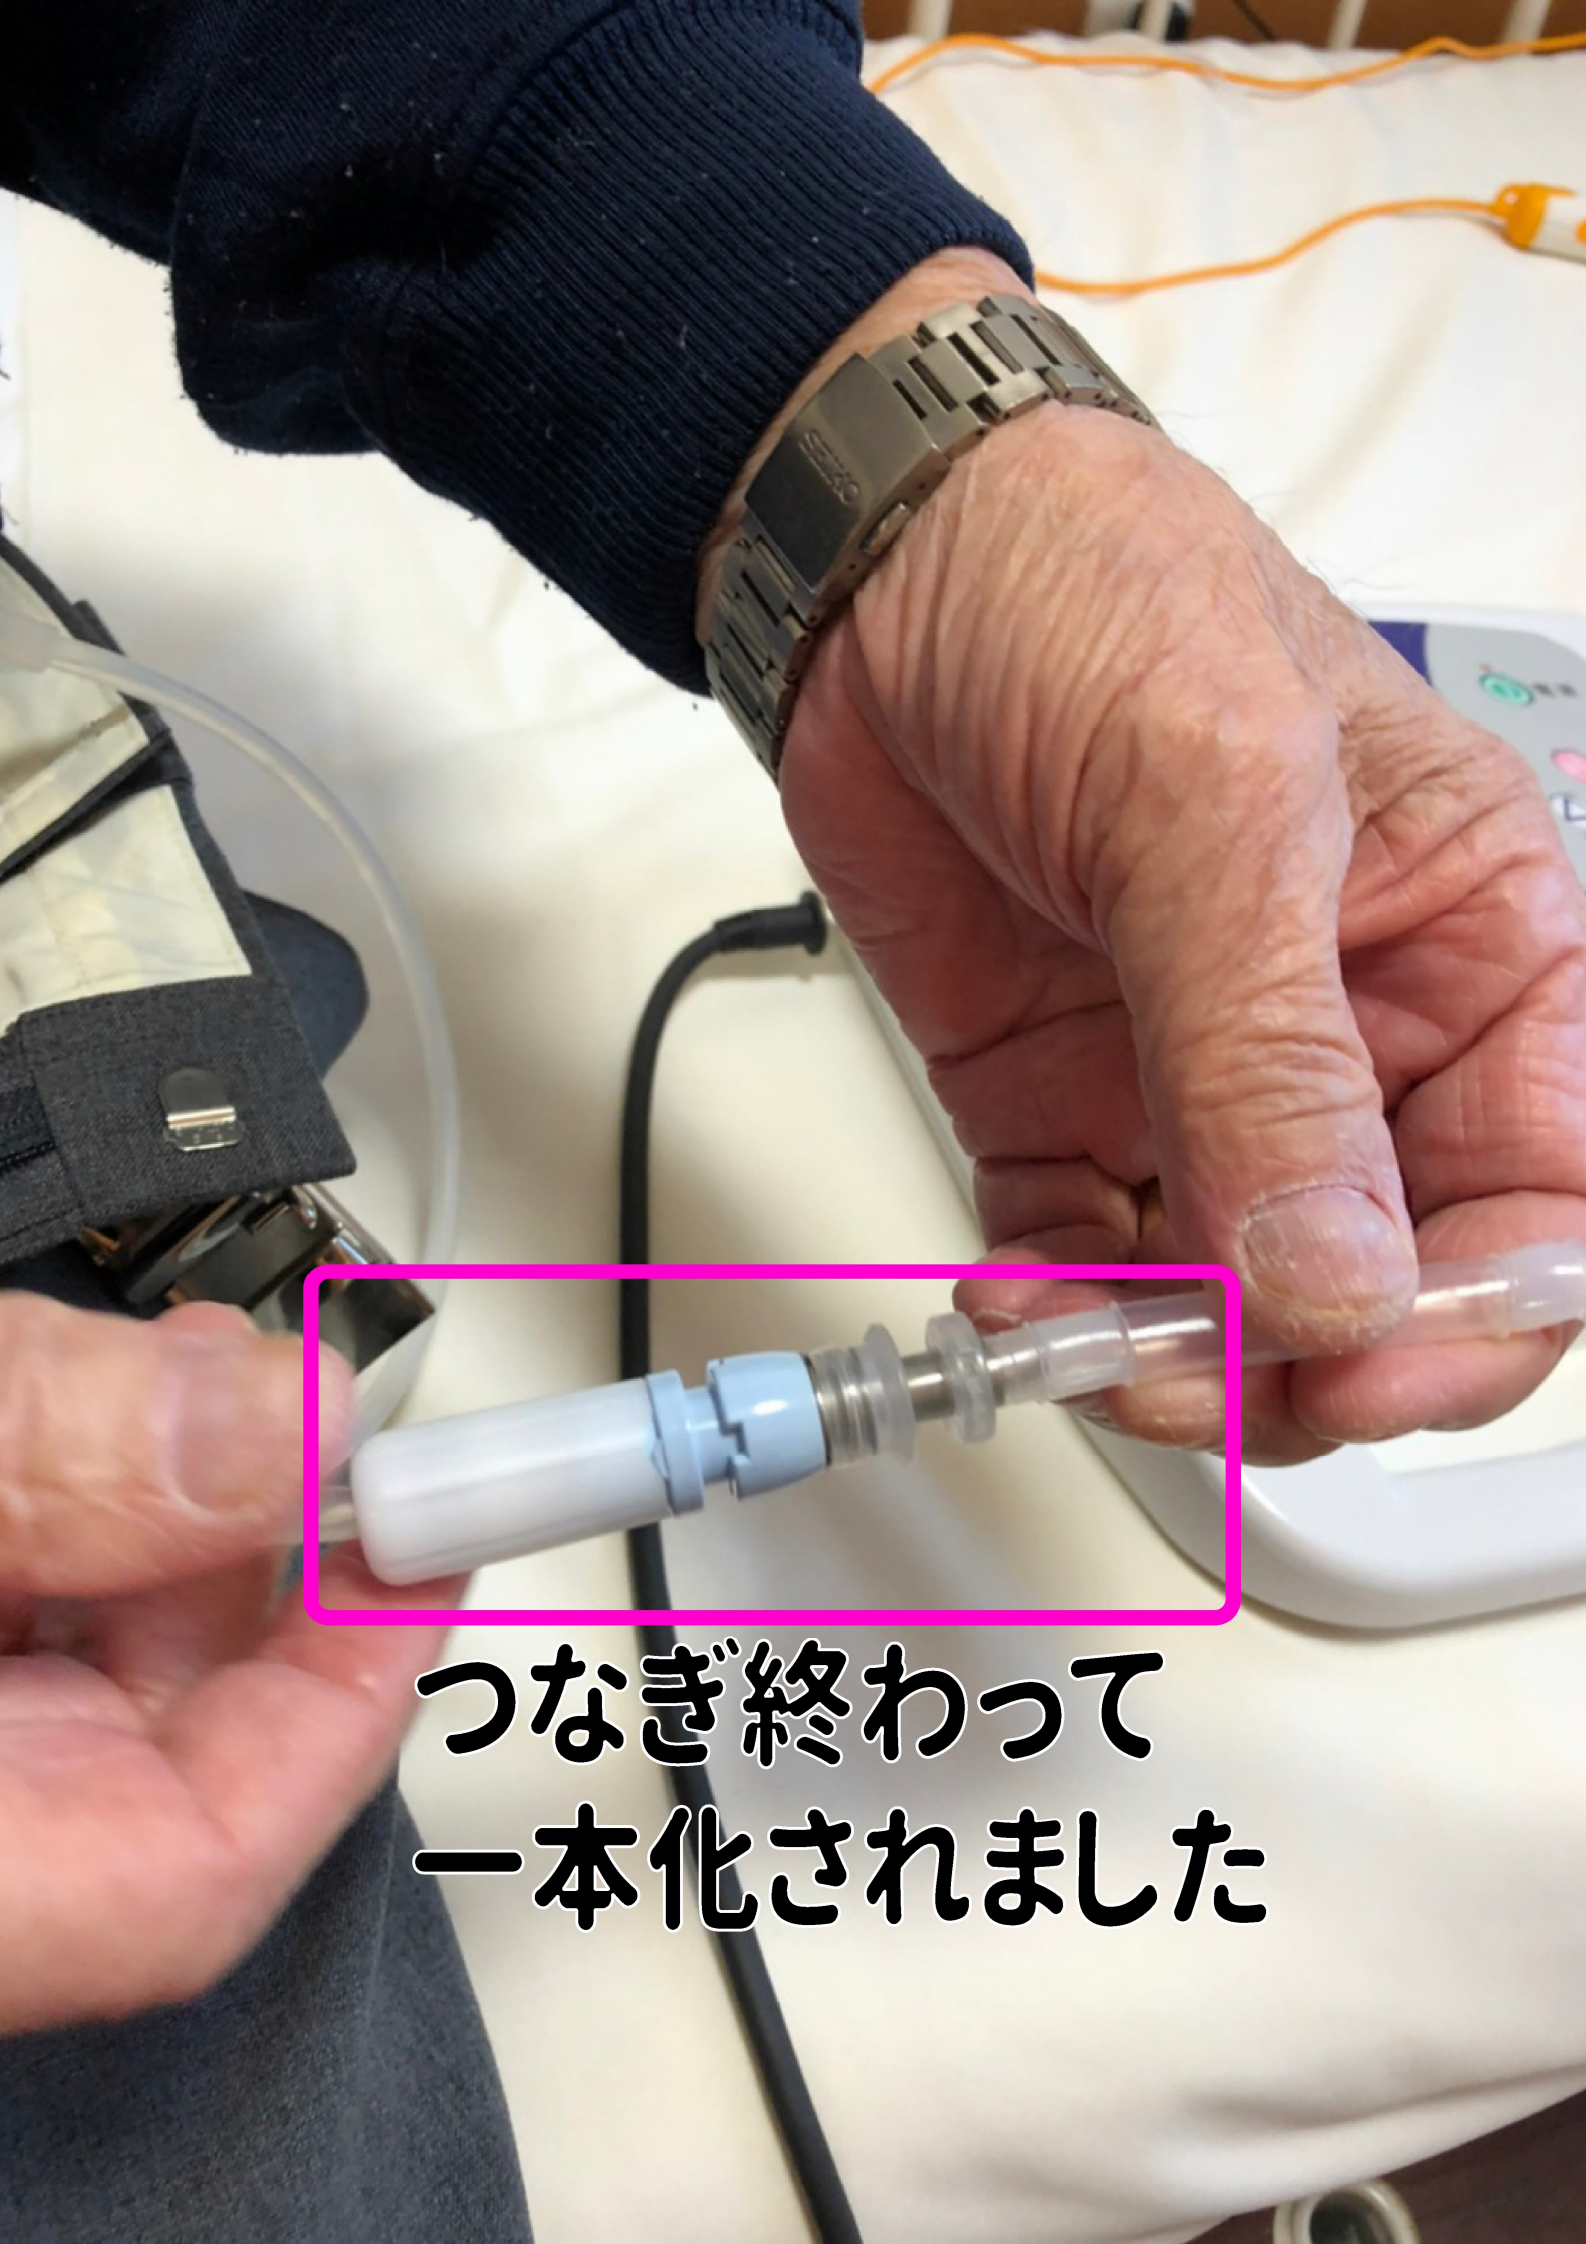

隔壁開通をして
よく混ぜます
レキュニール
HCa 2.5
2000mL
レキュニール HCa 2.5 腹膜透析液
バクスター株式会社
PH6523N
2023 .3
①→②の順にて開通させて下さい
開通確認


ここ
下から巻き上げるように
ルート側壁も開通


「つなぐ」で接続するので
緑の先端をご本人へ

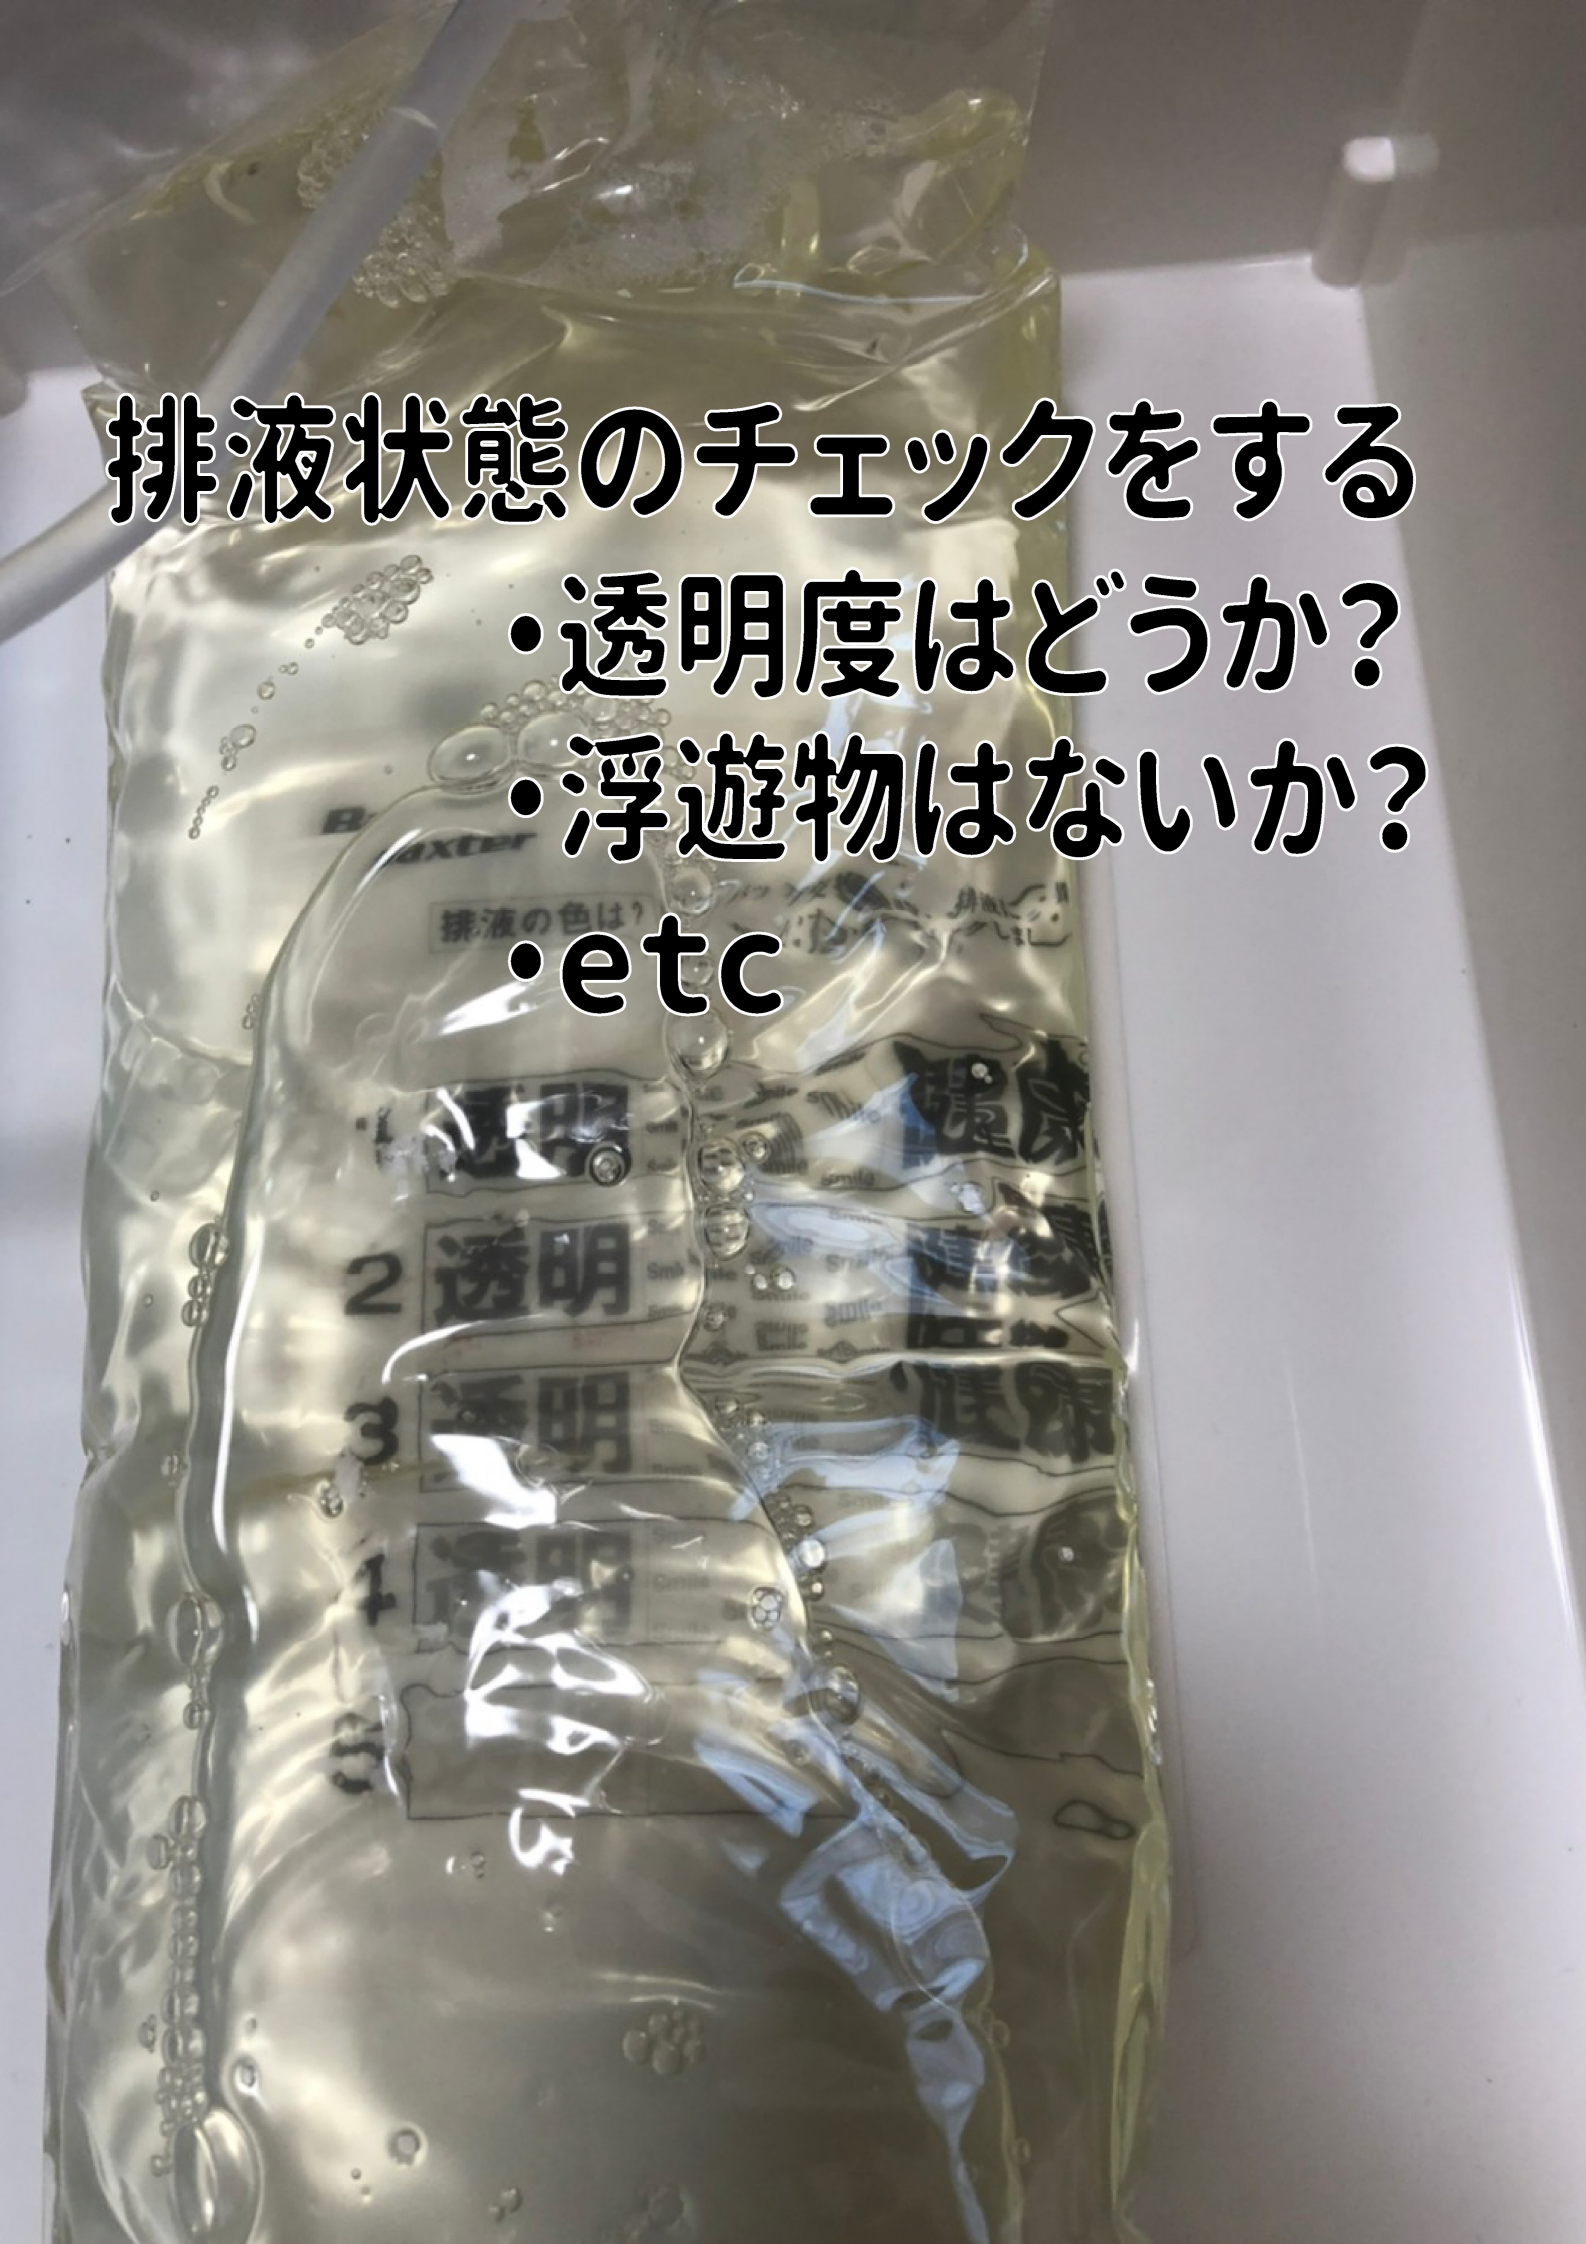


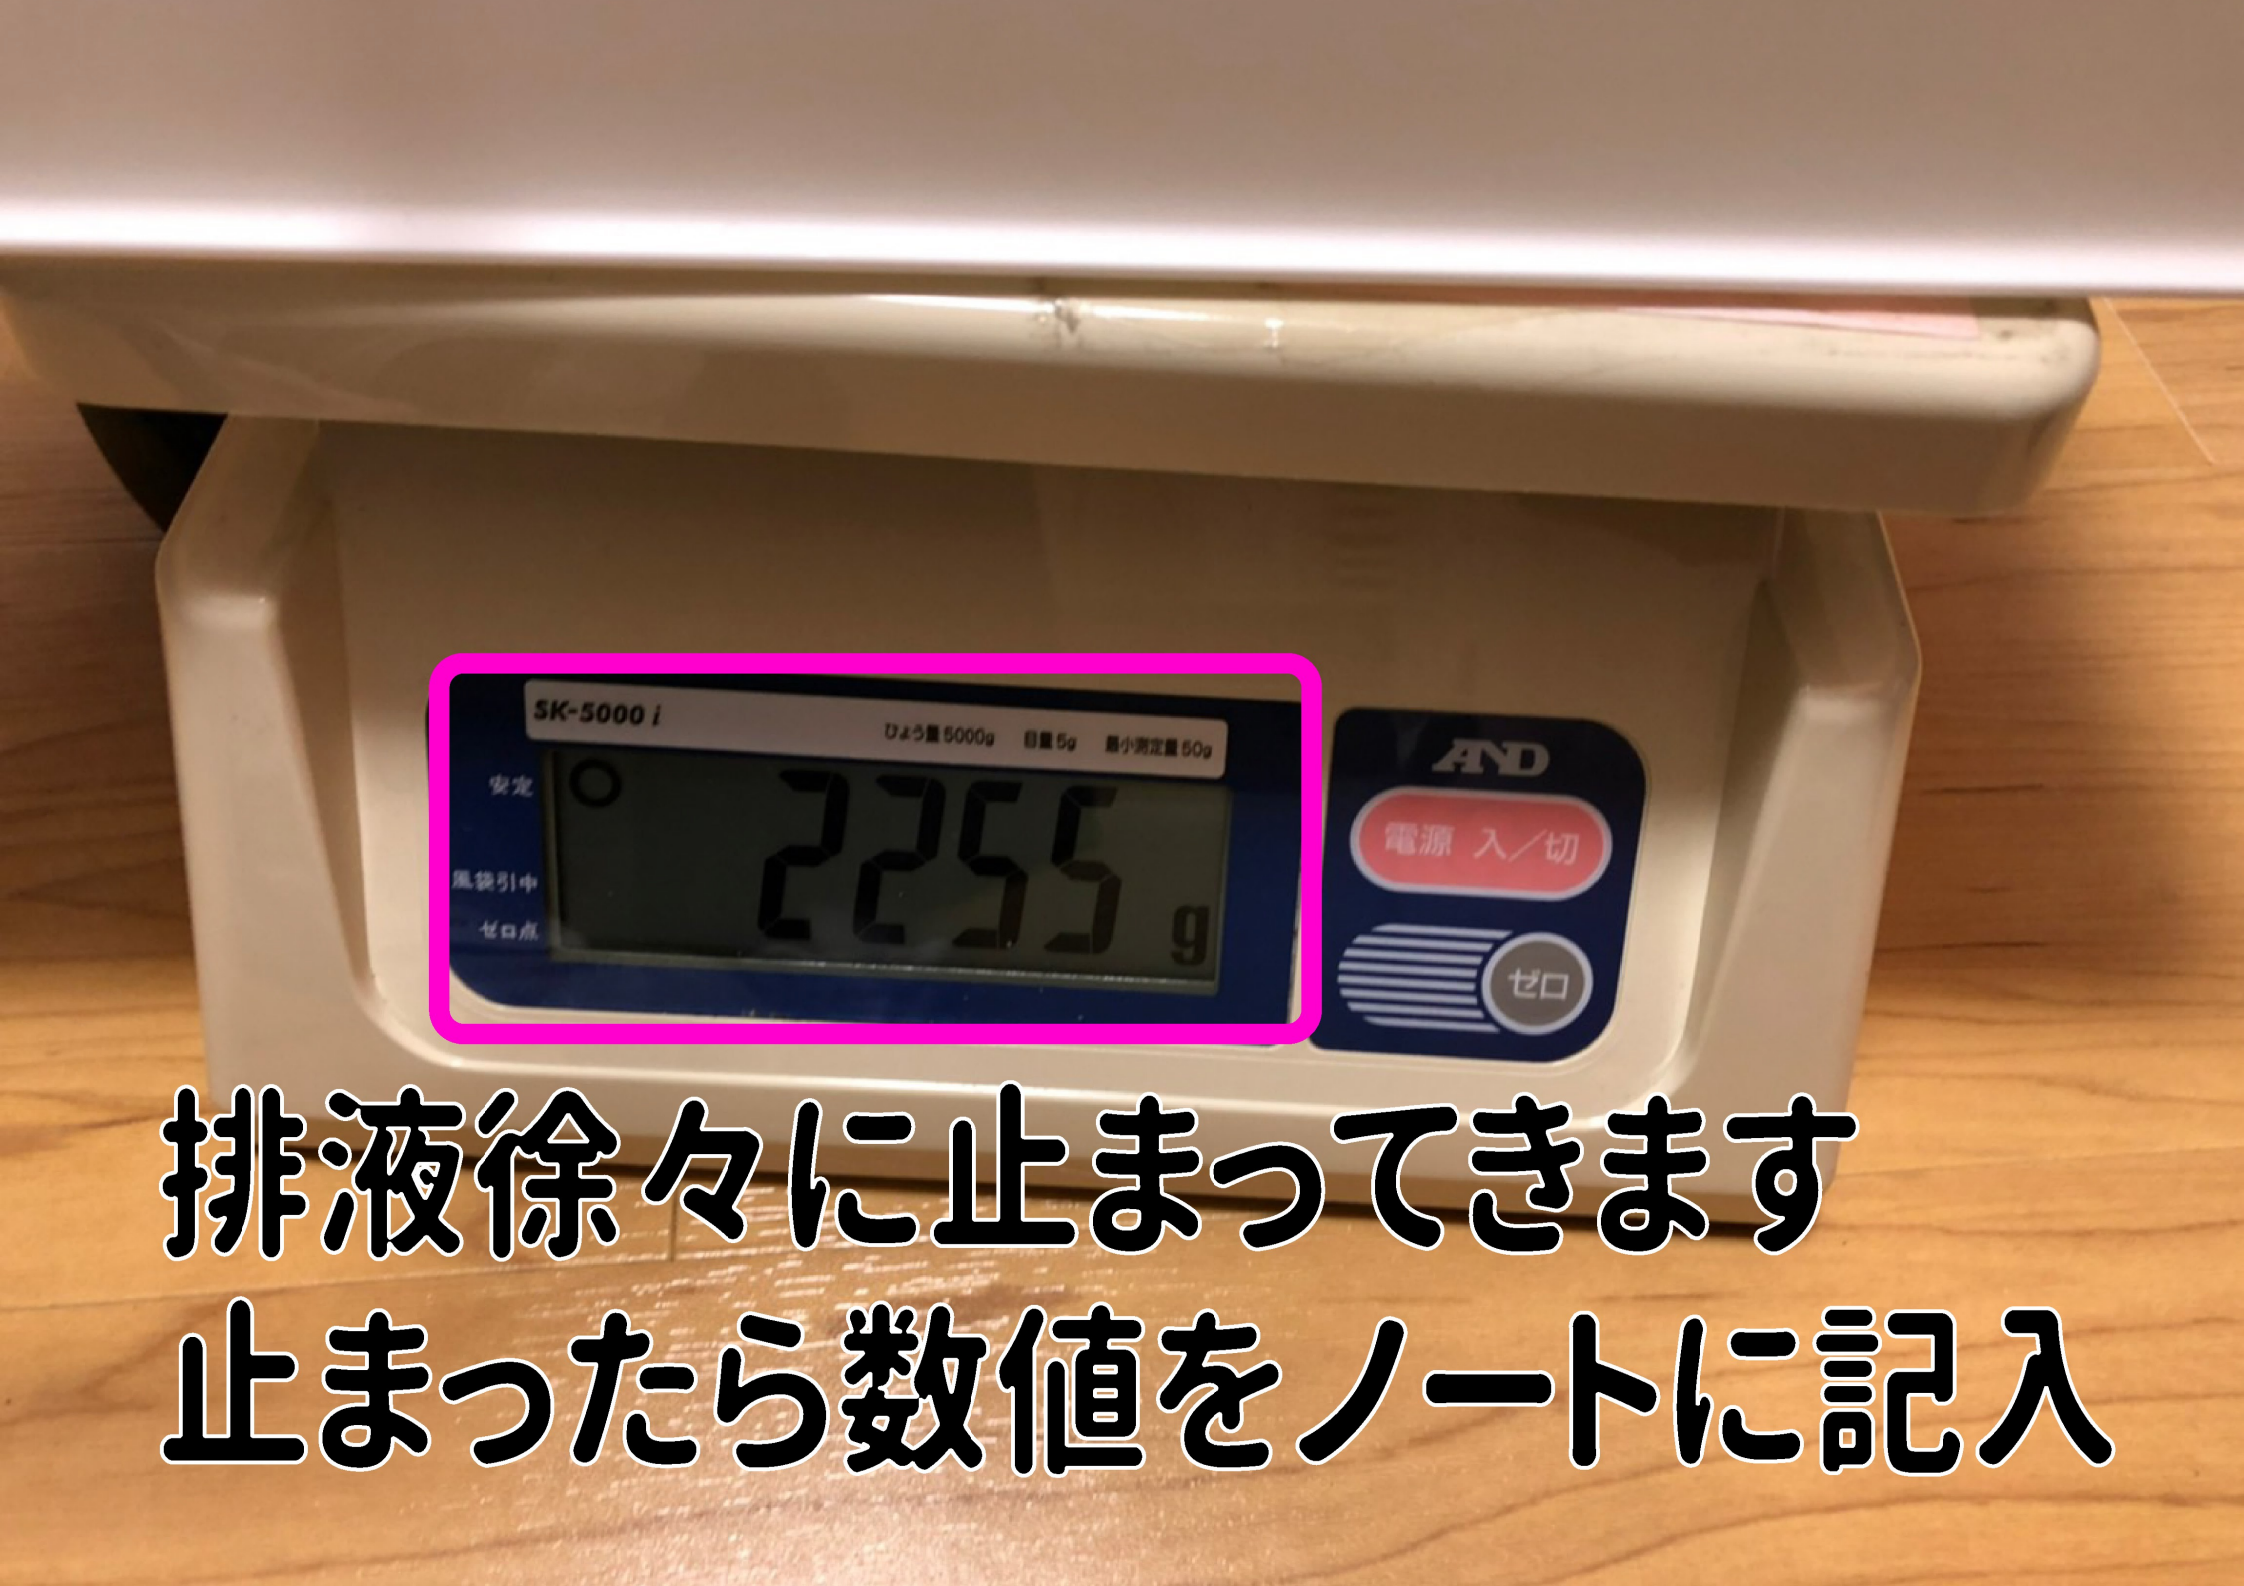
ご本人のカテーテル先端と
透析チューブ先端を
「つなぐ」でつなぎます


つなぎ終わって
一本化されました


ねじって開放状態にします


白クランプを
開放すると
排液スタート


排液状態のチェックをする
・透明度はどうか？
・浮遊物はないか？
・etc
排液の色は？
透明
透明
透明



排液徐々に止まってきます
止まったら数値をノートに記入

透析液濃度	レダ 1.5・2.5・4.25・エ	レダ 1.5・2.5・4.25・エ	レダ 1.5・2.5・4.25・エ
排液量	2300 g	2380 g	g
注液量	2160 g	2095 g	g
除水量	140 g	285 g	
排液時間	20 分	25 分	分
	正常 フィブリン 混濁 他（4~5の頃	正常 フィブリン 混濁 他（	正常 フィブリ 混濁 他（

除水量	425 g	体重	51.5 kg
量	750 ml	排便	回
飲水量	990 ml	血圧	104/58 mmHg
部の状態	正常・赤み・痛み・はれ・かさぶた・じゅくじゅく 出血・膿（色　　）その他		

年 10 月 21 日 木 曜日

貯留時間	10:00~13:00	13:30~ :	: ~ :	
透析液濃度	レダ 1.5・2.5・4.25・エ	レダ 1.5・2.5・4.25・エ	レダ 1.5・2.5・4.25・エ	レダ
排液量	2250 g	g	g	
注液量	2095 g	g	g	
除水量	g	g	g	
排液時間	20 分	分	分	
排液の確認	正常 フィブリン 混濁 他（　）	正常 フィブリン 混濁 他（　）	正常 フィブリン 混濁 他（　）	

一日の総除水量	g	体重	50.8 kg	備考
	ml	排便	回	
尿量				


本人側の本体部分を
必ず閉めて
青・白クランプ開放
5秒程度液を流して
プライミングします
必ず閉める


※測定前にカゴを
載せた状態で「0」か確認
AND


2075g
プライミング後の透析液
注入量をはかります
これをノートに記入

3 年 10 月 20 日 水 曜日

貯留時間	~~10:00~~ 13:00	13:~~00~~30 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
透析液濃度	レダ 1.5・(2.5)・4.25・エ	レダ 1.5・(2.5)・4.25・エ	レダ 1.5・2.5・4.25・エ	レダ 1.5・2.5・4.25・エ	レダ 1.5・2.5・4.25
排液量	2300 g	2380 g	g	g	
注液量	2160 g	2095 g	g	g	
除水量	140 g	285 g	g	g	
排液時間	20 分	25 分	分	分	
排液の確認	正常 フィブリン 混濁 他(4~5cm 程度)	(正常) フィブリン 混濁 他(ストレス)	正常 フィブリン 混濁 他( )	正常 フィブリン 混濁 他( )	正常 フィブリン 混濁 他(

				備考
一日の総除水量	425 g	体重	51.5 kg	下痢
尿量	750 ml	排便	回	
飲水量	990 ml	血圧	104/58 mmHg	
出口部の状態	正常・赤み・痛み・はれ・かさぶた・じゅくじゅく 出血・膿(色) その他			

3 年 10 月 21 日 木 曜日

貯留時間	10:00~13:00	13:30~ :	: ~ :		
透析液濃度	レダ 1.5・(2.5)・4.25・エ	レダ 1.5・(2.5)・4.25・エ	レダ 1.5・2.5・4.25・エ	レダ	
排液量	2250 g	g	g		
注液量	2095 g	2075 g	g		
除水量	g	g	g		
排液時間	20 分	分	分	分	
排液の確認	(正常) フィブリン 混濁 他( )	正常 フィブリン 混濁 他( )	正常 フィブリン 混濁 他( )	正常 フィブリン 混濁 他( )	正常 フィブ 混濁 他(

				備考
一日の総除水量	g	体重	50.8 kg	
尿量	ml	排便	回	
飲水量	~~990~~ ml	血圧	96/51 mmHg	
出口部の状態	正常・赤み・痛み・はれ・かさぶた・じゅくじゅく 出血・膿(色) その他			


本人側 開けます


青クランプ
開放して
注液開始

注液終了


青クランプ
閉じます


電源
くり返し
ホームPDシステム
本人ルートしめます


緑キャップを渡します



ご本人が「つなぐ」内に
セットしてくれます



一体化されたものが
切り離されます


ご本人がコンパクトに
まとめてくれます


腹まき内に収納して
終わりとなります